

Technische Daten


Kompaktes Hörbrillenmodul mit 312er Batterie. Für Anpassbereiche, Produktdetails und verfügbare Optionen, konsultieren Sie bitte die Produktinformation oder besuchen Sie www.bruckhoff.com.

Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Messungen mit 5 mm Schlauchlänge in Phonak Target Messeinstellung durchgeführt.


Ohr-Simulator-Daten

IEC 60118-0: 1994

Ausgangsschalldruck

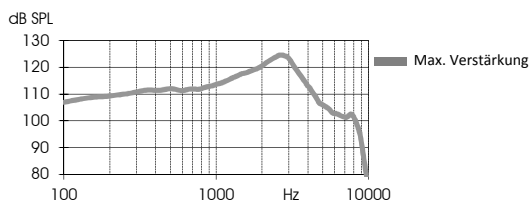


Akustische Verstärkung

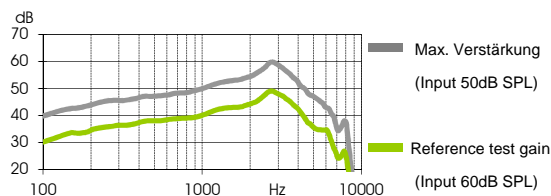

Frequenzbereich	<100 Hz - 6800 Hz		
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
Batteriestrom	Ruhe	Betrieb	
	1 mA	1.1 mA	
Aquivalentes Eigenrauschen	19 dB SPL		

Empfindlichkeit der Induktionsspule

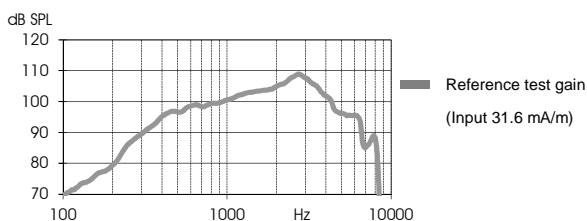

la belle 2 Virto B (B90/B70/B50/B30) (P)


Hinweis: Messungen von digitalen Hörsystemen mit Sinustönen können einen welligen Frequenzgang zur Folge haben. Dieses Artefakt ist auf die Verwendung eines schmalbandigen Eingangssignals zurückzuführen und spiegelt nicht die tatsächliche Leistung bei breitbandigen Eingangssignalen wider.

2 cm³ Kuppler-Daten


ANSI/ASA S3.22.2014

IEC 60118-7: 2015

Ausgangsschalldruck

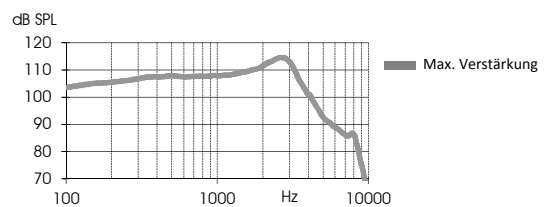

Akustische Verstärkung

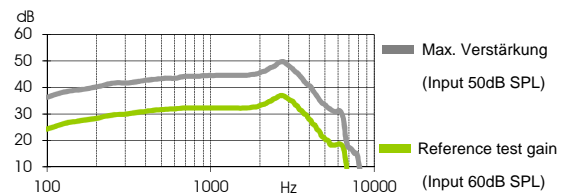

Frequenzbereich	<100 Hz - 6700 Hz		
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
Batteriestrom	Betrieb		
	1.2 mA		
Aquivalentes Eigenrauschen	19 dB SPL		

Empfindlichkeit der Induktionsspule

